



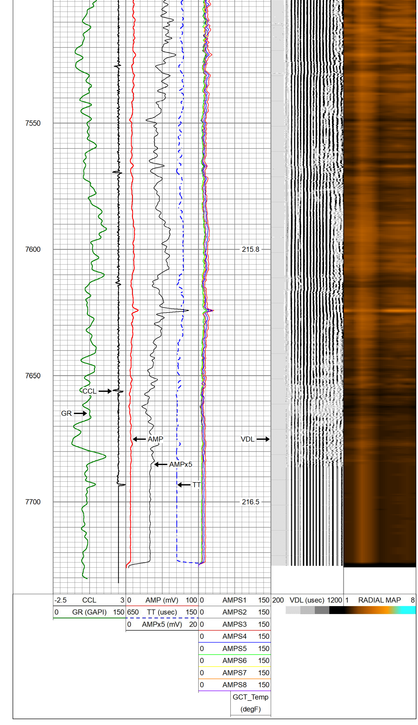

-2.5	CCL	3	0	AMP (mV)	100	0	AMPS1	150	200	VDL (usec)	1200	1	RADIAL MAP	8
0	GR (GAPI)	150	650	TT (usec)	150	0	AMPS2	150						
			0	AMPx5 (mV)	20	0	AMPS3	150						
						0	AMPS4	150						
						0	AMPS5	150						
						0	AMPS6	150						
						0	AMPS7	150						
						0	AMPS8	150						
							GCT_Temp (degF)							

REPEAT SECTION

Database File	civitas anschutz equus farms 4-62-16-6104c.db
Dataset Pathname	pass2
Presentation Format	sfww_cbl_oasis-sectors (2)
Dataset Creation	Sat Sep 10 16:24:32 2022
Charted by	Depth in Feet scaled 1:240

-2.5 CCL 3 | 0 AMP (mV) 100 | 0 AMPS1 150 | 200 VDL (usec) 1200 | 1 RADIAL MAP 8
0 GR (GAPI) 150 | 650 TT (usec) 150 | 0 AMPS2 150
0 AMPx5 (mV) 20 | 0 AMPS3 150
0 AMPS4 150
0 AMPS5 150
0 AMPS6 150
0 AMPS7 150
0 AMPS8 150
GCT_Temp (degF)

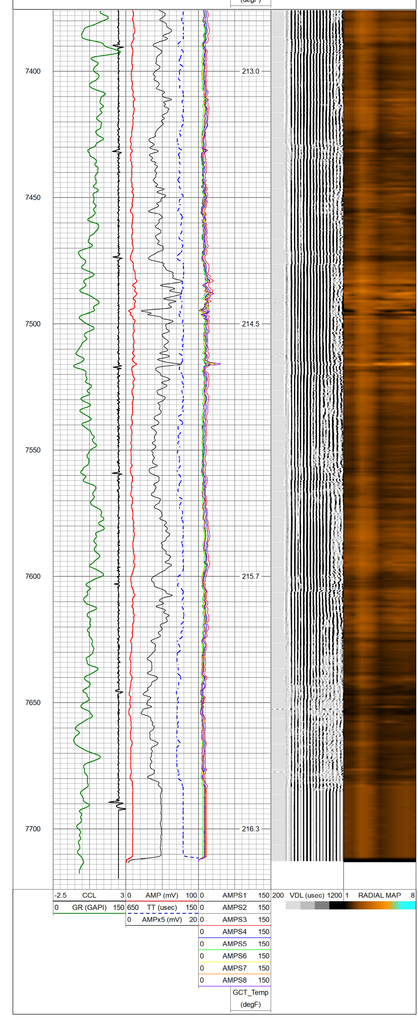

-2.5 CCL 3 | 0 AMP (mV) 100 | 0 AMPS1 150 | 200 VDL (usec) 1200 | 1 RADIAL MAP 8
0 GR (GAPI) 150 | 650 TT (usec) 150 | 0 AMPS2 150
0 AMPx5 (mV) 20 | 0 AMPS3 150
0 AMPS4 150
0 AMPS5 150
0 AMPS6 150
0 AMPS7 150
0 AMPS8 150
GCT_Temp (degF)

Calibration Report

Database File	civitas anschutz equus farms 4-62-16-6104c.db
Dataset Pathname	pass3
Dataset Creation	Sat Sep 10 16:30:52 2022

Gamma Ray Calibration Report

Serial Number:	FW1905-098	
Tool Model:	GCT275-0000	
Performed:	Mon May 4 14:03:10 2020	
Calibrator Value:	1.0	GAPI
Background Reading:	0.0	cps
Calibrator Reading:	1.0	cps
Sensitivity:	0.5800	GAPI/cps

Segmented Cement Bond Log Calibration Report

Serial Number:	FW1905-055	
Tool Model:	Probe	
Calibration Casing Diameter:	5.500	in
Calibration Depth:	284.833	ft

Master Calibration, performed Thu Sep 1 15:03:03 2022:

	Raw (v)		Calibrated (mv)		Results	
	Zero	Cal	Zero	Cal	Gain	Offset
3'	0.000	1.669	0.800	71.921	42.634	0.783
CAL	-0.000	1.792				
5'	-0.000	1.493	0.800	71.921	47.619	0.816
SUM						
S1	0.001	1.575	0.000	71.921	45.688	-0.033
S2	0.001	1.618	0.000	71.921	44.474	-0.027
S3	0.000	1.708	0.000	71.921	42.125	-0.010
S4	-0.001	1.719	0.000	71.921	41.812	0.031
S5	0.000	1.632	0.000	71.921	44.086	-0.007
S6	0.001	1.590	0.000	71.921	45.272	-0.051
S7	0.000	1.576	0.000	71.921	45.656	-0.021
S8	0.000	1.565	0.000	71.921	45.968	-0.021

Internal Reference Calibration, performed (Not Performed):

	Raw (v)		Calibrated (v)		Results	
	Zero	Cal	Zero	Cal	Gain	Offset
CAL	0.000	0.000	-0.000	1.792	1.000	0.000

Air Zero Calibration, performed Tue Sep 21 11:19:14 2021:

	Raw (v)	Calibrated (v)	Results
	Zero	Zero	Offset
3'	0.000	0.000	0.000
5'	0.000	0.000	0.000
SUM			
S1	0.000	0.000	0.000
S2	0.000	0.000	0.000
S3	0.000	0.000	0.000
S4	0.000	0.000	0.000
S5	0.000	0.000	0.000
S6	0.000	0.000	0.000
S7	0.000	0.000	0.000
S8	0.000	0.000	0.000